

經濟部標準檢驗局 函

機關地址：100臺北市中正區濟南路1段4號
聯絡人/聯絡電話：侯沛霖/(02)23963360-726
電子郵件：os.hou@bsmi.gov.tw
傳 真：(02)23970715

10846

台北市長沙街二段73號3樓

受文者：台北市儀器商業同業公會



發文日期：中華民國104年10月22日

發文字號：經標四字第10440014461號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：「噪音計檢定檢查技術規範」，業經本局於中華民國104年10月22日以經標四字第10440014460號公告修正，檢送公告影本（含附件）及修正對照表各1份，請查照。

正本：司法院秘書長、行政院經濟能源農業處、行政院法規會、法務部、經濟部法規委員會、行政院環境保護署、行政院環境保護署環境督察總隊、行政院環境保護署環境檢驗所、勞動部職業安全衛生署、勞動部職業安全衛生署北區職業安全衛生中心、勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心、勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心、勞動部勞動及職業安全衛生研究所、國防部、國防部空軍司令部、空軍軍官學校、國防部陸軍司令部、陸軍航空特戰指揮部、臺北市政府環境保護局、新北市政府環境保護局、臺中市政府環境保護局、臺南市政府環境保護局、高雄市政府環境保護局、基隆市環境保護局、宜蘭縣政府環境保護局、桃園市政府環境保護局、新竹縣政府環境保護局、新竹市環境保護局、苗栗縣政府環境保護局、彰化縣環境保護局、雲林縣環境保護局、南投縣政府環境保護局、嘉義縣環境保護局、嘉義市政府環境保護局、屏東縣政府環境保護局、臺東縣環境保護局、花蓮縣環境保護局、澎湖縣政府環境保護局、金門縣環境保護局、國立臺灣海洋大學、財團法人工業技術研究院量測技術發展中心、財團法人台灣電子檢驗中心、泰仕電子工業股份有限公司、台灣思百吉股份有限公司、台灣愛克發吉華股份有限公司、維斯美股份有限公司、宏衛科技股份有限公司、利音貿易開發股份有限公司、山衛科技股份有限公司、瑩誥科技股份有限公司、青山儀器容器有限公司、合立儀器股份有限公司、南榮貿易股份有限公司、群特科技股份有限公司、九連環境開發股份有限公司、三普環境分析股份有限公司、上準環境科技股份有限公司、中央科技顧問有限公司、台旭環境科技中心股份有限公司、安美環保科技股份有限公司



訂

線

司、技佳工程顧問有限公司、亞太環境科技股份有限公司、佳美環境科技股份有限公司、東典環安科技股份有限公司、松喬環保科技股份有限公司、南台灣環境科技股份有限公司、建利環保顧問股份有限公司、思維環境科技有限公司、祥威環境科技有限公司、琨鼎環境科技股份有限公司、祐大技術顧問股份有限公司、清華科技驗證股份有限公司、衛宇檢驗科技股份有限公司、中環科技事業股份有限公司、台灣檢測股份有限公司、兆鼎檢驗科技有限公司、汎美科技企業有限公司、華光工程顧問股份有限公司、道濟製藥廠股份有限公司、三陽工業股份有限公司、台灣山葉機車工業股份有限公司、台灣本田汽車股份有限公司、裕隆汽車製造股份有限公司、臺北市度量衡商業同業公會、桃園市度量衡商業同業公會、臺中市度量衡商業同業公會、彰化縣度量衡商業同業公會、臺南市度量衡商業同業公會、高雄市度量衡商業同業公會、台北市儀器商業同業公會、桃園市儀器商業同業公會、台中市儀器商業同業公會、彰化縣儀器商業同業公會、臺南市儀器商業同業公會、高雄市儀器商業同業公會、台北市度量衡裝修業職業工會、力山環境科技股份有限公司、啟誠科技股份有限公司、合迪股份有限公司、日商清原股份有限公司台灣分公司、佳利得科技股份有限公司、愛主志業有限公司、華新工程顧問有限公司、魔髮獅股份有限公司、弘碩科技有限公司、世駿電子股份有限公司、展典有限公司、凱鉅科技實業股份有限公司、歐怡科技股份有限公司、森鴻科技儀器有限公司、天時儀器股份有限公司、智安貿易股份有限公司、惟聖實業有限公司、詠同貿易有限公司、松璟科技有限公司、柏新科技股份有限公司、捷思環能有限公司、淇荃環保科技有限公司、景泰環保場技股份有限公司、新紀工程顧問有限公司、冠羿驗證股份有限公司、新美檢驗科技有限公司、精湛檢驗科技股份有限公司、維呈顧問股份有限公司、謙德檢驗股份有限公司、正修科技大學超微量研究科技中心、澳新科技股份有限公司、國瑞汽車股份有限公司、光陽工業股份有限公司、本局第七組、法務室、資訊室、基隆分局、新竹分局、臺中分局、臺南分局、高雄分局、花蓮分局、商品安全諮詢中心

副本：


局長 劉明忠

檔 號：

保存年限：

經濟部標準檢驗局 公告

發文日期：中華民國104年10月22日
發文字號：經標四字第10440014460號
附件：「噪音計檢定檢查技術規範」

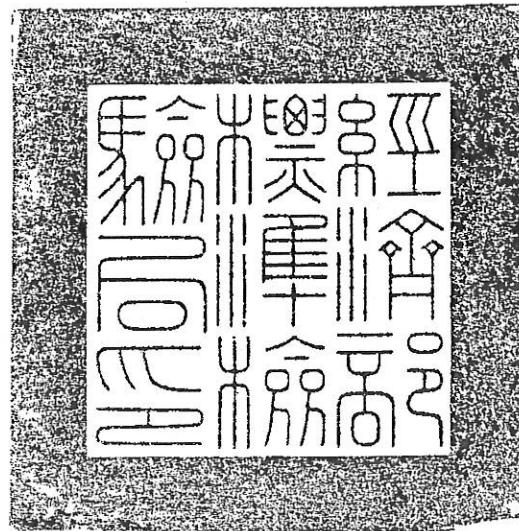

主旨：修正「噪音計檢定檢查技術規範」，並自中華民國一百零六年一月一日生效。

依據：度量衡法第十四條第二項及第十六條第二項。

公告事項：

- 一、修正機關：經濟部標準檢驗局。
- 二、「噪音計檢定檢查技術規範」如附件。

局長 劉明忠

	噪音計檢定檢查技術規範	編號	CNMV 58-1
		版次	第 2 版

一、本技術規範依度量衡法第十四條第二項及第十六條第二項規定訂定之。

二、本技術規範歷次公告日期、文號、實施日期及修正內容如下：

版次	公告日期	文號（經標四字）	實施日期	修 正 內 容
----	------	----------	------	---------

1	92.07.04	第 09240006030 號	92.08.01	
---	----------	-----------------	----------	--

考量噪音計相關國際規範業已更新，為符合國際發展趨勢、國內法規及產業需求，爰參考 IEC 61672 系列規範及 OIML R 58 建議規範之內容，並衡酌國內檢定、檢查實務現況進行修正。

公 告 日 期 104 年 10 月 22 日	經濟部標準檢驗局	實 施 日 期 106 年 1 月 1 日
----------------------------	----------	--------------------------

1. 適用範圍

1.1 本技術規範適用於應受檢定、檢查之時間加權、時間平均噪音計，提供 1 級與 2 級兩種噪音計等級的性能要求。

1.2 具倍頻濾波器之噪音計應先經本技術規範檢定合格。

2. 用詞定義

2.1 音壓(sound pressure)：瞬時總壓與相對應的靜壓之間的差值。

註：音壓以帕斯卡(Pa)表示

2.2 音壓位準(sound pressure level)：取均方根音壓對參考音壓的平方比之對數再乘以 10。

註：音壓位準以分貝(dB)表示；參考音壓為 $20 \mu\text{Pa}$ 。

2.3 頻率加權(frequency weighting)：顯示裝置上顯示的頻率加權訊號位準與相對應的恆幅正弦輸入訊號位準之間的差值，為特定的頻率函數。例如 A 加權、C 加權及 Z 加權。

2.4 時間加權音壓位準(time-weighted sound level)：取特定時間常數的指數時間函數的頻率加權音壓訊號對參考音壓的平方比之對數再乘以 10。

2.5 時間平均音壓位準(time-averaged sound level)：取指定的時間間隔期間內頻率加權音壓訊號的平均對參考音壓的平方比之對數再乘以 10。

2.6 位準範圍(level range)：噪音計標稱的聲音位準量測範圍。

註：位準範圍以分貝(dB)表示，例如 50 dB 至 110 dB 的範圍。

2.7 參考音壓位準(reference sound pressure level)：指定於測試噪音計電聲性能的音壓位準。

2.8 參考位準範圍(reference level range)：指定於測試噪音計電聲特性並含參考音壓位準的位準範圍。

2.9 校正查核頻率(calibration check frequency)：聲音校正器所產生音壓的標稱頻率。

2.10 位準線性偏差(level linearity deviation)：指定頻率所顯示的訊號位準減去預期訊號位準。

2.11 線性工作範圍(linear operating range)：在指定頻率的任何位準範圍上位準線性偏差未超過本標準所規定之公差的位準範圍。

2.12 猝發音(toneburst)：開始與結束於波形零交點之一個或多個完整迴圈之正弦電訊號。

2.13 猝發音響應(toneburst response)：量測猝發音的最大時間加權的訊號位準減去量測猝發音相對應的穩定輸入訊號位準。

3. 檢定及檢查設備

3.1 檢定、檢查使用之設備應具下列規格：

(1) 聲音校正器：符合 IEC 60942 之一級聲音校正器，最大擴充不確定度未滿 0.2 dB。

(2) 標準麥克風：符合 IEC 61094-1 之實驗室標準麥克風或 IEC 61094-4 之工作標準麥克風，頻率範圍至少為 31.5 Hz 至 16 kHz，最大擴充不確定度未滿 0.2 dB。

(3) 衰減器：衰減可變範圍 60 dB 以上，解析度(最小分度值) 0.1 dB 以下，最大擴充不確定度未滿 0.2 dB。

註：如正弦訊號產生器的電壓輸出範圍 60 dB 以上，則可不使用衰減器。

(4) 電壓表：頻率範圍至少為 20 Hz 至 20 kHz，電壓量測誤差 1 % 以下。

(5) 正弦訊號產生器：頻率範圍至少為 20 Hz 至 20 kHz，輸出頻率誤差 0.25 % 以下。

(6) 無響音場裝置：背景噪音 20 dB(A) 以下。由距音源中心位置 0.5 m 至 1.1 m 範圍，自由場特性之容許偏差(deviation)如表 1。

表 1 無響音場裝置自由場特性之容許偏差

聲訊號環境需求	1/3 倍頻中心頻率(Hz)	容許偏差(dB)
全無響室環境	≤630	±1.5
	800 至 5000	±1.0
	≥6300	±1.5

註：由上述的容許偏差決定無響音場裝置可使用的頻率範圍。

(7) 音場測試聲源：頻率範圍至少為 250 Hz 至 20 kHz、輸出音壓位準超過背景噪音 30 dB 以上。

註：測試頻率低於音場截止頻率時，以封閉的耦合腔聲源取代測試聲源。

(8) 耦合腔測試聲源：頻率範圍涵蓋 31.5 Hz 至 250 Hz、音壓位準 70 dB 以上。

註：如無響音場裝置可滿足之測試頻率範圍，則可不使用耦合腔測試聲源。

(9) 猝發音訊號產生器：猝發音訊號頻率為 4 kHz，持續時間範圍至少為 0.25 ms 至 1000ms。

註：如正弦訊號產生器可產生猝發音訊號，則可不使用猝發音訊號產生器。

(10) 前置放大器：頻率範圍 20 Hz 至 20 kHz。

(11) 量測放大器：頻率範圍 20 Hz 至 20 kHz。

註：如麥克風輸出電壓可由電壓表量測，則可不使用量測放大器。

上述(1)至(5)項設備須提出設備具追溯性及量測不確定度之驗證證明。

3.2 檢定、檢查環境條件：

- (1) 溫度範圍：20 °C 至 26 °C；
- (2) 相對濕度範圍：25 % 至 70 %；
- (3) 大氣壓力範圍：80 kPa 至 105 kPa。
- (4) 在開始與結束測試時必須測量與記錄大氣壓力、溫度與相對濕度。

4. 構造

4.1 噪音計之計量單位為「分貝」，其符號為「dB」。

4.2 噪音計應在主機明顯之處標明以下資訊：

- (1) 噪音計等級的標示(例：1 級或 2 級)。
- (2) 製造廠商名稱或商標。
- (3) 產品型號及出廠器號(包含麥克風之型號及器號)。

4.3 噪音計必須有 A 頻率加權特性。

4.4 噪音計必須有時間加權特性，如快速(F 或 FAST)，慢速(S 或 SLOW)；積分式噪音計必須有時間平均特性。

4.5 噪音計應備有保持量測音壓位準最大值之功能。

4.6 噪音計應具備有過載輸入之指示裝置。

4.7 噪音計指示器上之顯示值解析度(最小分度值)應在 0.1 dB 以下。

4.8 噪音計指示器上的顯示範圍至少有 60 dB。

註：如可調整不同顯示範圍，則具有時間加權功能的噪音計兩相鄰的指示範圍需有 30 dB 的重疊；具有時間平均功能的噪音計兩相鄰的指示範圍需有 40 dB 的重疊。

4.9 噪音計使用乾電池時，須有提供電壓不足之警報裝置。

4.10 麥克風必須是可以與噪音計本體分離的，以容許插入電氣測試訊號於前置放大器的輸入端。

5. 檢定程序

5.1 噪音計之構造及規格特性，依下列項目進行檢定之。

- (1) 構造。
- (2) 校正查核頻率的指示。
- (3) 自雜訊。
- (4) 聲訊號頻率加權。
- (5) 電訊號頻率加權。
- (6) 位準線性度。
- (7) 位準範圍切換。
- (8) 猶發音響應。
- (9) 過載指示。
- (10) 1k Hz 頻率及時間加權。
- (11) 長時間穩定性。
- (12) 高位準穩定性。

註：若為多通道噪音計系統，依受檢測者需求的通道數，逐一檢定所有的檢定項目。

5.2 構造：應符合第 4 節之規定。

5.3 校正查核頻率的指示：

- (1) 將噪音計設定在使用手冊規定之頻率、時間加權特性(如未規定可設定於頻率加權 A、時間加權 Fast)及參考位準範圍。
- (2) 如圖 1 噪音計接收已校正的聲音校正器發出之音壓位準進行指示值的調整及記錄。

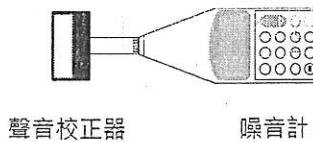


圖 1 噪音計查核頻率校正

5.4 自雜訊之檢測規定如下：

- (1) 噪音計自雜訊量測分為安裝麥克風及使用電性輸入訊號裝置取代麥克風兩種測試方式。
- (2) 安裝麥克風檢測時，噪音計設定在音量最大感受範圍並選擇 A 頻率加權，如圖 2 所示在無響音場裝置的環境進行量測。
- (3) 使用電性輸入訊號裝置取代麥克風檢測時，參考說明書上所規定的端接方式如圖 3，噪音計設定在音量最大感受範圍並選擇 A 頻率加權。
- (4) 記錄噪音計至少 30 s 時間平均之 A 加權所顯示的音量。
- (5) 如果不能測定時間平均音量，必須從間隔 60 s 的 10 次隨機觀察中測量 S 時間加權(或 F 時間加權)音量。

註：自雜訊的 A 加權音量只作為參考之用，並不用來評鑑是否符合要求，無相關的不確定度。

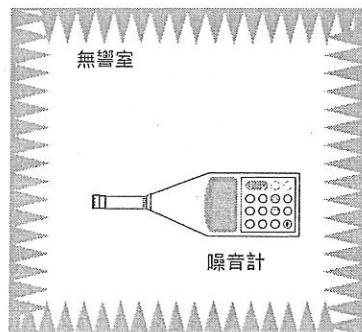


圖 2 噪音計聲訊號自雜訊測試




圖 3 噪音計電訊號自雜訊測試

5.5 聲訊號頻率加權檢測規定如下：

5.5.1 於無響音場裝置中檢測

- (1) 噪音計設定在頻率加權 A 及參考位準範圍(或使用者量測的位準範圍)。
- (2) 使用已校正過的標準麥克風為參考標準於無響音場裝置的環境測試頻率加權。
- (3) 如圖 4 所示接妥各儀器，並依製造商所規定之暖機時間暖機。
- (4) 調整正弦訊號產生器的輸出電壓使標準麥克風距離測試聲源 1 m 處各頻率之音壓位準超過 70 dB 以上。
- (5) 在頻率為 31.5 Hz、63 Hz、125 Hz、250 Hz、500 Hz、1 kHz、2 kHz、4 kHz、8 kHz 及 16 kHz 測定聲音訊號的頻率加權。
- (6) 將受檢噪音計取代標準麥克風於相同位置處，量測頻率加權之音壓位準值，計算與標準麥克風無加權時各頻率音壓位準之差值。
- (7) 於無響音場裝置中應執行在 1.00 m、1.05 m 及 1.10 m 不同距離之檢測的算術平均值。

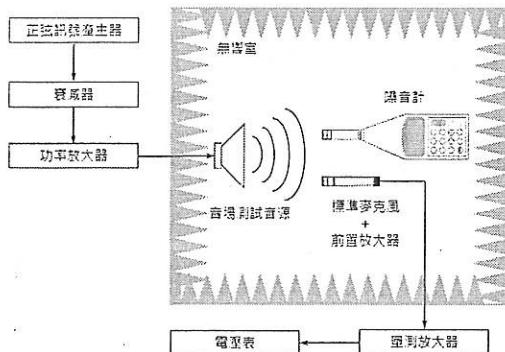


圖 4 噪音計聲訊號頻率加權檢測系統(無響音場裝置)

5.5.2 於耦合腔裝置中檢測

(當無響音場裝置無法符合自由場環境之頻率且於 250 Hz 以下時，得使用耦合腔裝置進行聲訊號頻率加權檢測)

- (1) 噪音計設定在頻率加權 A 及參考位準範圍(或使用者量測的位準範圍)。
- (2) 使用已校正過的標準麥克風為參考標準安裝於耦合腔測試聲源中測試頻率加權。
- (3) 如圖 5 所示接妥各儀器，並依製造商所規定之暖機時間暖機。
- (4) 調整正弦訊號產生器的輸出電壓使標準麥克風在各頻率之音壓位準為 70 dB 至 125 dB。
- (5) 將受檢噪音計取代標準麥克風，量測頻率加權之音壓位準值，計算與標準麥克風無加權時各頻率音壓位準之差值。
- (6) 於耦合腔裝置中應執行至少 3 次檢測的算術平均值。每次測試時必須將麥克風自耦合腔中移除重新安裝。

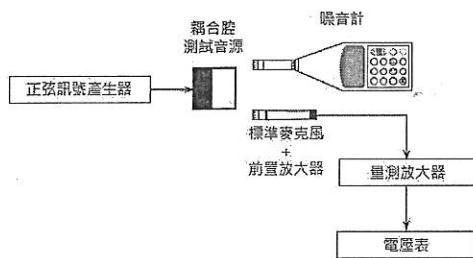


圖 5 噪音計聲訊號頻率加權檢測系統(耦合腔裝置)

5.6 電訊號頻率加權檢測規定如下：

- (1) 將噪音計上之麥克風取下，以與麥克風阻抗相等之電性輸入訊號裝置連接於噪音計的前置放大器端。
- (2) 如圖 6 所示接妥各儀器，並依製造商所規定之暖機時間暖機。
- (3) 噪音計之位準範圍設定在參考位準範圍(或使用者量測的位準範圍)，頻率加權設定在 Z、A 或 C 加權特性。
- (4) 正弦訊號產生器輸出為 1 kHz 正弦訊號，調整輸入訊號的位準，使噪音計顯示於主要指示範圍上限以下 5 dB 處，並以此為參考位準。
- (5) 按表 1 之頻率點逐一改變訊號頻率，求取相對於參考位準之差值並逐點作出響應曲線，以取得 Z、A、C 各加權特性。
- (6) 量測值應為至少 3 次檢測的算術平均值。

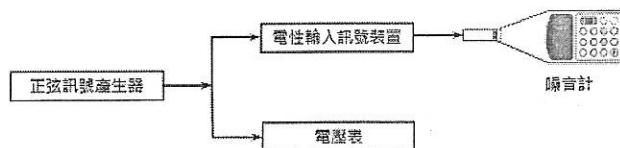


圖 6 噪音計電訊號頻率加權檢測系統

5.7 位準線性度檢測規定如下：

- (1) 將噪音計上之麥克風取下，以與麥克風阻抗相等之電性輸入訊號裝置連接於噪音計的前置放大器端。
- (2) 圖 7 所示接妥各儀器，並依製造商所規定之暖機時間暖機。
- (3) 噪音計之位準範圍設定在參考位準範圍(或使用者量測的位準範圍)，頻率加權設定在 A

加權特性。時間加權設定在 F 時間加權或時間平均。

- (4) 正弦訊號產生器的輸出為 8 kHz 正弦訊號，調整輸入訊號的位準，使噪音計顯示於參考位準，在此參考位準之位準線性偏差為零。
- (5) 調整衰減器(或正弦訊號產生器)的位準，以 .5 dB 以下的變化來調整輸入訊號的位準。當與線性工作範圍的下限或上限相距不到 5 dB 時以及當位準超過上限時，輸入訊號位準的變化則減到 1 dB。
- (6) 計算訊號產生器輸入位準與相對應噪音計輸出位準之線性偏差。
- (7) 量測值應為至少 3 次檢測的算術平均值。

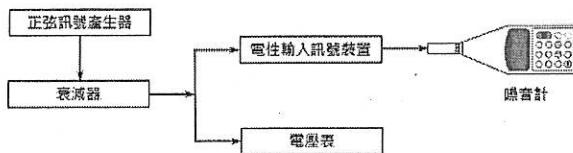


圖 7 噪音計位準線性度檢測系統

5.8 位準範圍切換檢測規定如下(適用於多個位準範圍之噪音計)：

- (1) 將噪音計上之麥克風取下，以與麥克風阻抗相等之電性輸入訊號裝置連接於噪音計的前置放大器端。
- (2) 如圖 7 所示接妥各儀器，並依製造商所規定之暖機時間暖機。
- (3) 噪音計之位準範圍設定在參考位準範圍(或使用者量測的位準範圍)，頻率加權設定在 A 加權特性。時間加權設定在 F 時間加權或時間平均。
- (4) 正弦訊號產生器的輸出為 1 kHz 正弦訊號，調整輸入訊號的位準，使噪音計顯示於主要指示範圍上限以下 5 dB。
- (5) 改變噪音計位準範圍切換器各級範圍檔，再調整精密衰減器(或正弦訊號產生器)，使噪音計指示不變。
- (6) 計算位準範圍切換器改變量與精密衰減器(或正弦訊號產生器)改變量之差。
- (7) 量測值應為至少 3 次檢測的算術平均值。

5.9 猝發音響應檢測規定如下：

- (1) 將噪音計上之麥克風取下，以與麥克風阻抗相等之電性輸入訊號裝置連接於噪音計的前置放大器端。
- (2) 圖 8 所示接妥各儀器，並依製造商所規定之暖機時間暖機。
- (3) 噪音計之位準範圍設定在參考位準範圍(或使用者量測的位準範圍)，頻率加權設定在 A 加權特性。時間加權設定在 F 時間加權、S 時間加權或時間平均。
- (4) 正弦訊號產生器的輸出為 4 kHz 正弦訊號，調整輸入訊號的位準，使噪音計顯示於主要指示範圍上限以下 3 dB 處，並以此為參考位準。
- (5) 保持與上述位準相同的輸入訊號，用持續時間為 200 ms、2 ms 及 0.25 ms(對快速及時間平均) 及 200 ms、2 ms(對慢速)之 4 kHz 單個暫態音輸入受檢噪音計，其最大顯示值與等幅連續正弦訊號顯示值之差值。
- (6) 量測值應為至少 3 次檢測的算術平均值。

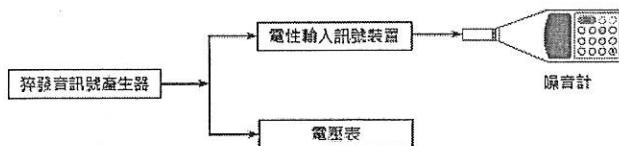


圖 8 噪音計猝發音響應檢測系統

5.10 過載指示檢測規定如下：(適用於可以顯示時間平均音量的噪音計)

- (1) 將噪音計上之麥克風取下，以與麥克風阻抗相等之電性輸入訊號裝置連接於噪音計的前置放大器端。
- (2) 圖 9 所示接妥各儀器，並依製造商所規定之暖機時間暖機。
- (3) 位準範圍設定在最小感受音量範圍且設定 A 加權、時間平均音量。
- (4) 正弦訊號產生器的輸出為 4 kHz 正弦訊號，調整輸入訊號的位準，使噪音計顯示於主要指示範圍上限以下 1 dB 處。
- (5) 再從 4 kHz 穩定連續的正弦訊號提取正半個週期輸入噪音計，以 0.1 dB 的步進方式輸入訊號至噪音計出現過載指示，記錄此時的位準值，再輸入負半個週期的正弦訊號，以同樣的方式獲得位準值，計算兩者的差值。
- (6) 量測值應為至少 3 次檢測的算術平均值。



圖 9 噪音計過載指示檢測系統

5.11 1 kHz 頻率及時間加權檢測規定如下：

- (1) 將噪音計上之麥克風取下，以與麥克風阻抗相等之電性輸入訊號裝置連接於噪音計的前置放大器端。
- (2) 圖 10 所示接妥各儀器，並依製造商所規定之暖機時間暖機。
- (3) 位準範圍設定在參考位準範圍且設定 A 加權、FAST。
- (4) 正弦訊號產生器的輸出為 1 kHz 正弦訊號。
- (5) 記錄切換至 C 加權及 Z 加權與 A 加權時的差值。
- (6) 記錄切換至 SLOW 及時間平均與 FAST 的差值。
- (7) 量測值應為至少 3 次檢測的算術平均值。

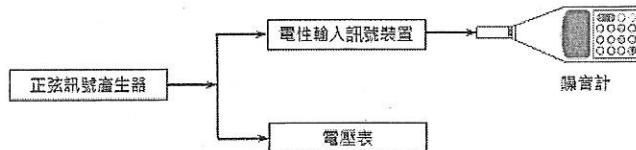


圖 10 噪音計 1 kHz 頻率及時間加權檢測系統

5.12 長時間穩定性檢測規定如下：

- (1) 將噪音計上之麥克風取下，以與麥克風阻抗相等之電性輸入訊號裝置連接於噪音計的前置放大器端。
- (2) 圖 11 所示接妥各儀器，並依製造商所規定之暖機時間暖機。

- (3) 噪音計之位準範圍設定在參考位準範圍(或使用者量測的位準範圍)，頻率加權設定在 A 加權特性。時間加權設定在 F 時間加權或時間平均 10 s。
- (4) 正弦訊號產生器的輸出為 1 kHz 正弦訊號，調整輸入訊號的位準，使噪音計在主要指示範圍顯示 60 dB，持續 30 分鐘。
- (5) 記錄噪音計顯示值於起始訊號與結束訊號之間的差異。
- (6) 量測值應為至少 3 次檢測的算術平均值。

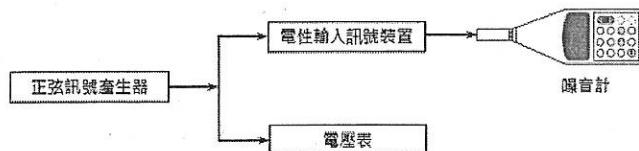


圖 11 噪音計長時間穩定性檢測系統

5.13 高位準穩定性檢測規定如下：

- (1) 將噪音計上之麥克風取下，以與麥克風阻抗相等之電性輸入訊號裝置連接於噪音計的前置放大器端。
- (2) 如圖 12 所示接妥各儀器，並依製造商所規定之暖機時間暖機。
- (3) 噪音計之位準範圍設定在參考位準範圍(或使用者量測的位準範圍)，頻率加權設定在 A 加權特性。時間加權設定在 F 時間加權或時間平均 10 s。
- (4) 正弦訊號產生器的輸出為 1 kHz 正弦訊號，調整輸入訊號的位準，使噪音計顯示於主要指示範圍上限以下 1 dB 處，持續 5 分鐘。
- (5) 記錄噪音計顯示值於起始訊號與結束訊號之間的差異。
- (6) 量測值應為至少 3 次檢測的算術平均值。

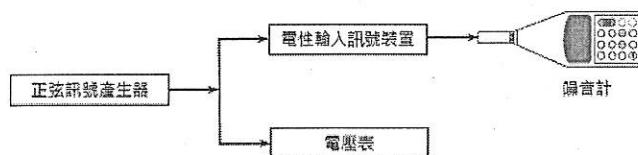


圖 12 噪音計高位準穩定性檢測系統

5.14 噪音計之檢定合格有效期間，自附加檢定合格印證之日起至附加檢定合格印證月份之次月始日起算 2 年止。

6. 檢查程序得採本技術規範中全部或部分檢定項目實施。

7. 檢定及檢查公差

7.1 噪音計之各項檢定公差如下：

- (1) 頻率加權：

表 2 頻率加權特性及公差

標稱頻率 (Hz)	頻率加權(dB)			公差(dB)	
	A	C	Z	1 級	2 級
20	-50.5	-6.2	0.0	±2.0	±3.0
25	-44.7	-4.4	0.0	+2.0;- 1.5	±3.0
31.5	-39.4	-3.0	0.0	±1.5	±3.0
40	-34.6	-2.0	0.0	±1.0	±2.0
50	-30.2	-1.3	0.0	±1.0	±2.0
63	-26.2	-0.8	0.0	±1.0	±2.0
80	-22.5	-0.5	0.0	±1.0	±2.0
100	-19.1	-0.3	0.0	±1.0	±1.5
125	-16.1	-0.2	0.0	±1.0	±1.5
160	-13.4	-0.1	0.0	±1.0	±1.5
200	-10.9	0.0	0.0	±1.0	±1.5
250	-8.6	0.0	0.0	±1.0	±1.5
315	-6.6	0.0	0.0	±1.0	±1.5
400	-4.8	0.0	0.0	±1.0	±1.5
500	-3.2	0.0	0.0	±1.0	±1.5
630	-1.9	0.0	0.0	±1.0	±1.5
800	-0.8	0.0	0.0	±1.0	±1.5
1000	0	0	0	±0.7	±1.0
1250	+0.6	0.0	0.0	±1.0	±1.5
1600	+1.0	-0.1	0.0	±1.0	±2.0
2000	+1.2	-0.2	0.0	±1.0	±2.0
2500	+1.3	-0.3	0.0	±1.0	±2.5
3150	+1.2	-0.5	0.0	±1.0	±2.5
4000	+1.0	-0.8	0.0	±1.0	±3.0
5000	+0.5	-1.3	0.0	±1.5	±3.5
6300	-0.1	-2.0	0.0	+1.5;- 2.0	±4.5
8000	-1.1	-3.0	0.0	+1.5;- 2.5	±5.0
10000	-2.5	-4.4	0.0	+2.0;- 3.0	+5.0; - ∞
12500	-4.3	-6.2	0.0	+2.0;- 5.0	+5.0; - ∞
16000	-6.6	-8.5	0.0	+2.5;- 16.0	+5.0; - ∞
20000	-9.3	-11. 2	0.0	+3.0;- ∞	+5.0; - ∞

(2) 位準線性度：

1 級噪音計，位準線性偏差 ± 0.8 dB 以下。

2 級噪音計，位準線性偏差 ± 1.1 dB 以下。

(3) 猥發音響應：

表 3 猥發音響應及公差

猝發音持續時間(ms)	猝發音響應(dB)		公差(dB)	
	F 時間加權	時間平均	1 級	2 級
200	-1.0	-7.0	±0.5	±1.0
2	-18.0	-27.0	+1.0;-1.5	+1.0;-2.5
0.25	-27.0	-36.0	+1.0;-3.0	+1.5;-5.0
	S 時間加權			
200	-7.4		±0.5	±1.0
2	-27.0		+1.0;-3.0	+1.0;-5.0

(4) 過載指示檢測：偏差± 1.5 dB 以下。

(5) 1 kHz 頻率及時間加權檢測：

頻率加權切換偏差± 0.2 dB 以下。

時間加權切換偏差± 0.1 dB 以下。

(6) 長時間穩定性：

1 級噪音計，± 0.1 dB 以下。

2 級噪音計，± 0.3 dB 以下。

(7) 高位準穩定性：

1 級噪音計，± 0.1 dB 以下。

2 級噪音計，± 0.3 dB 以下。

7.2 噪音計之各項檢定在涵蓋機率為 95 %，最大容許擴充不確定度如表 4。

表 4 檢定項目之最大容許擴充不確定度

檢定項目	最大容許擴充不確定度
A、C、Z 頻率加權	0.60 dB(10 Hz 至 4 kHz) 0.70 dB(4 kHz 以上至 10 kHz) 1.00 dB(10 kHz 以上至 20 kHz)
位準線性偏差	0.30 dB
猝發音響應	0.30 dB
過載顯示	0.25 dB
1 kHz 頻率及時間加權	0.20 dB
長時間穩定性	0.10 dB
高度穩定性	0.10 dB

7.3 噪音計之檢查公差與檢定公差相同。

8. 檢定合格印證及證書

8.1 噪音計之檢定合格印證位置，在主機上蓋明顯處黏貼檢定合格單。

8.2 檢定合格後應發給檢定合格證書。

8.3 噪音計檢定合格證書應記載下列項目：申請者、地址、規格、廠牌、型號、器號、類型、檢定合格單號碼、檢定日期、有效期限及其他必要事項。


噪音計檢定檢查技術規範修正條文對照表

修 正 條 文	現 行 條 文	說 明
1. 適用範圍	1. 適用範圍： <u>本規範適用於應受檢定檢查之噪音計。</u>	由於各種噪音計之量測功能並不相同，為增加易讀性，爰明定相關適用範圍。
1.1 本技術規範適用於應受檢定、檢查之時間加權、時間平均噪音計，提供1級與2級兩種噪音計等級的性能要求。		一、 <u>本節新增</u> 。 二、參考IEC 61672-1第1節之規定，明定噪音計的適用範圍。
1.2 具倍頻濾波器之噪音計應先經本技術規範檢定合格。		一、 <u>本節新增</u> 。 二、明定具倍頻濾波器之噪音計應先經本技術規範檢定合格，始得辦理倍頻濾波器噪音計之檢定。
2. 用詞定義		一、 <u>本節新增</u> 。 二、為增加易讀性，新增用詞定義之節次。
2.1 音壓(sound pressure)：瞬時總壓與相對應的靜壓之間的差值。 註：音壓以帕斯卡(Pa)表示		一、 <u>本節新增</u> 。 二、參考IEC 61672-1第3.1節之規定，明定音壓之定義。
2.2 音壓位準(sound pressure level)：取均方根音壓對參考音壓的平方比之對數再乘以10。 註：音壓位準以分貝(dB)表示；參考音壓為20 μPa。		一、 <u>本節新增</u> 。 二、參考IEC 61672-1第3.2節之規定，明定音壓位準之定義。
2.3 頻率加權(frequency weighting)：顯示裝置上顯示的頻率加權訊號位準與相對應的恆幅正弦輸入訊號位準之間的差值，為特定的頻率函數。例如A加權、C加權及Z加權。		一、 <u>本節新增</u> 。 二、參考IEC 61672-1第3.3節之規定，明定頻率加權之定義。
2.4 時間加權音壓位準(time-weighted sound level)：取特定時間常數的指數時間函數的頻率加權音壓訊號對參考音壓的平方比之對數再乘以10。		一、 <u>本節新增</u> 。 二、參考IEC 61672-1第3.4、3.6節之規定，明定時間加權音壓位準之定義。
2.5 時間平均音壓位準(time-averaged sound level)：取指定的時間間隔期間內頻率加權音壓訊號的平均對參考音壓的平方比之對數再乘以10。		一、 <u>本節新增</u> 。 二、參考IEC 61672-1第3.10節之規定，明定時間平均音壓位準之定義。
2.6 位準範圍(level range)：噪音計標稱的聲音位準量測範圍。 註：位準範圍以分貝(dB)表示，例如50 dB至110 dB的範圍。		一、 <u>本節新增</u> 。 二、參考IEC 61672-1第3.22節之規定，明定位準範圍之定義。
2.7 參考音壓位準(reference sound pressure level)：指定於測試噪音計電聲性能的音壓位準。		一、 <u>本節新增</u> 。 二、參考IEC 61672-1第3.23節之規定，明定參考音壓位準之定義。



2.8 參考位準範圍(reference level range)： 指定於測試噪音計電聲特性並含參考音壓位準的位準範圍。		一、 <u>本節新增</u> 。 二、參考 IEC 61672-1 第 3.24 節之規定，明定參考位準範圍之定義。
2.9 校正查核頻率(calibration check frequency)：聲音校正器所產生音壓的標稱頻率。		一、 <u>本節新增</u> 。 二、參考 IEC 61672-1 第 3.25 節之規定，明定校正查核頻率之定義。
2.10 位準線性偏差(level linearity deviation)：指定頻率所顯示的訊號位準減去預期訊號位準。		一、 <u>本節新增</u> 。 二、參考 IEC 61672-1 第 3.26 節之規定，明定位準線性偏差之定義。
2.11 線性工作範圍(linear operating range)：在指定頻率的任何位準範圍上位準線性偏差未超過本標準所規定之公差的位準範圍。		一、 <u>本節新增</u> 。 二、參考 IEC 61672-1 第 3.27 節之規定，明定線性工作範圍之定義。
2.12 猝發音(toneburst)：開始與結束於波形零交點之一個或多個完整迴圈之正弦電訊號。		一、 <u>本節新增</u> 。 二、參考 IEC 61672-1 第 3.29 節之規定，明定猝發音之定義。
2.13 猝發音響應(toneburst response)：量測猝發音的最大時間加權的訊號位準減去量測猝發音相對應的穩定輸入訊號位準。		一、 <u>本節新增</u> 。 二、參考 IEC 61672-1 第 3.30 節之規定，明定猝發音響應之定義。
3. 檢定及檢查設備	3. 檢定、檢查與公差	為增加易讀性，將檢定及檢查設備與公差分開節次說明。
3.1 檢定、檢查使用之設備應具下列規格： (1) 聲音校正器：符合 IEC 60942 之一級聲音校正器，最大擴充不確定度未滿 0.2 dB。 (2) 標準麥克風：符合 IEC 61094-1 之實驗室標準麥克風或 IEC 61094-4 之工作標準麥克風，頻率範圍至少為 31.5 Hz 至 16 kHz，最大擴充不確定度未滿 0.2 dB。 (3) 衰減器：衰減可變範圍 60 dB 以上，解析度(最小分度值) 0.1 dB 以下，最大擴充不確定度未滿 0.2 dB。 註：如正弦訊號產生器的電壓輸出範圍 60 dB 以上，則可不使用衰減器。 (4) 電壓表：頻率範圍至少為 20 Hz 至 20 kHz，電壓量測誤差 1% 以下。 (5) 正弦訊號產生器：頻率範圍至少為 20 Hz 至 20 kHz，輸出頻率誤差 0.25 % 以下。 (6) 無響音場裝置：背景噪音	3.1 檢定、檢查設備：須提出驗證設備之系統具追溯性及不確定度驗證證明。 (1) 脈衝信號產生器：脈衝寬度 50 μs ~ 10 ms、上升時間不大於 10 μs、脈衝極性：正、負。 (2) 標準麥克風：頻率範圍 20 Hz ~ 16 kHz、音壓靈敏度位準不確定度 ± 0.2 dB (在參考頻率處)。 (3) 訊號產生器：頻率範圍 20 Hz ~ 20 kHz、頻率誤差小於 ± 1%、輸出電壓 1 mVrms ~ 5 Vrms、諧波失真不大於 0.5 %。 (4) 無響音場裝置：自由音場聲音偏差：在頻率數 125 Hz 以上，由距音源之音響中心起 0.5 m 至 1.0 m 範圍內，須具有容許偏差在 ± 1.0 dB 以下之自由音場特性。 頻率範圍至少包括 125 Hz 至 4000 Hz 範圍、背景噪音 20 dB(A) 以下。 (5) 測試聲源：頻率範圍 20 Hz ~ 20 kHz、最大音壓位準不低於 100 dB (離聲參考點 1 m 處)。 (6) 標準有效值電壓表：有效值量測	一、酌作文字修正。 二、參考 IEC 61672-3 第 9.3 及 IEC 60942 第 5.2.2 節之規定，增加聲音校正器之規格要求。 三、參考 IEC 61672-3 第 12.1 及 IEC 61672-2 第 9.1.2 節之規定，修訂標準麥克風之規格要求。 四、參考 IEC 61672-3 第 8.3 節之規定，修訂正弦訊號產生器輸出頻率之規格要求。 五、參考 IEC 61672-3 第 18.5 節及之 IEC 61672-2 第 9.12.6 節規定，明定猝發音訊號產生器之規格要求。 六、參考 IEC 61672-1 第 5.18.2 節之規定，位準線性度的量測範圍為 60 dB，修訂定衰減器之規格要求。

<p>20 dB(A)以下。由距音源中心位置0.5 m至1.1 m範圍，自由場特性之容許偏差(deviation)如表1。</p>	<p>不確定度1%。</p> <p>(7) 前置放大器：頻率範圍20 Hz~16 kHz、諧波失真在20 Hz~12.5 kHz範圍內不大於1%。</p> <p>(8) 量測放大器：不確定度優於±0.2 dB。</p> <p>(9) 衰減器：不確定度優於±(1% + 0.05) dB、頻率範圍20 Hz~20 kHz、最小衰減變換值0.1 dB。</p> <p>(10) 濾波器：頻率範圍20 Hz~20 kHz(含有1/3 Octave功能)。</p>	<p>七、參考IEC 61672-1附錄B最大容許不確定度之規定，修訂電壓表之規格要求。</p>						
<p>表1 無響音場裝置自由場特性之容許偏差</p>		<p>八、參考IEC 61672-2第9.1.8節及ISO 26101附錄A之規定，明定無響音場裝置之規格要求。</p>						
<table border="1" data-bbox="128 363 609 518"> <thead> <tr> <th>聲訊號環境需求</th><th>1/3倍頻中心頻率(Hz)</th><th>容許偏差(dB)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>全無響室環境</td><td>≤630 800至5000 ≥6300</td><td>±1.5 ±1.0 ±1.5</td></tr> </tbody> </table>	聲訊號環境需求	1/3倍頻中心頻率(Hz)	容許偏差(dB)	全無響室環境	≤630 800至5000 ≥6300	±1.5 ±1.0 ±1.5		<p>九、參考IEC 61672-3第12.8節及IEC 61672-2第9.4.3.4之規定，明定音場測試聲源之規格。</p>
聲訊號環境需求	1/3倍頻中心頻率(Hz)	容許偏差(dB)						
全無響室環境	≤630 800至5000 ≥6300	±1.5 ±1.0 ±1.5						
<p>(7) 音場測試聲源：頻率範圍至少為250 Hz至20 kHz、輸出音壓位準超過背景噪音30 dB以上。</p> <p>註：測試頻率低於音場截止頻率時，以封閉的耦合腔聲源取代測試聲源。</p>		<p>十、參考IEC 61672-3第12.1節及IEC 61672-2第9.4.4.1之規定，增加測試頻率低於音場截止頻率時，以封閉的耦合腔聲源取代音場測試聲源之註解。</p>						
<p>(8) 耦合腔測試聲源：頻率範圍涵蓋31.5 Hz至250 Hz、音壓位準70 dB以上。</p> <p>註：如無響音場裝置可滿足之測試頻率範圍，則可不使用耦合腔測試聲源。</p>		<p>十一、參考IEC 61672-3第12.10節之規定明定耦合腔測試聲源之音壓位準。</p>						
<p>(9) 猛發音訊號產生器：猛發音訊號頻率為4 kHz，持續時間範圍至少為0.25 ms至1000 ms。</p> <p>註：如正弦訊號產生器可產生猛發音訊號，則可不使用猛發音訊號產生器。</p>		<p>十二、依據測試範圍修訂前置放大器及量測放大器之規格。</p>						
<p>(10) 前置放大器：頻率範圍20 Hz至20 kHz。</p>								
<p>(11) 量測放大器：頻率範圍20 Hz至20 kHz。</p> <p>註：如麥克風輸出電壓可由電壓表量測，則可不使用量測放大器。</p>								
<p>上述(1)至(5)項設備須提出設備具追溯性及量測不確定度之驗證證明。</p>								
<p>3.2 檢定、檢查環境條件：</p> <p>(1) 溫度範圍：20 °C至26 °C；</p> <p>(2) 相對濕度範圍：25 %至70 %；</p> <p>(3) 大氣壓力範圍：80 kPa至105 kPa。</p> <p>(4) 在開始與結束測試時必須測量與記錄大氣壓力、溫度與相對濕度。</p>	<p>3.2 噪音計之所有測試必須在溫度為(23±5) °C、相對濕度為(55±15)%、大氣壓力為(101.3±5.0) kPa之環境狀況下執行。</p>	<p>一、參考IEC 61672-3第7.1節之規定，修訂檢定、檢查環境條件需求。</p> <p>二、參考IEC 61672-3第7.2節之規定，明定檢定期間應記錄環境條件的時機。</p> <p>三、酌作文字修正。</p>						
<p>4. 構造</p>	<p>2. 構造</p>	<p>節次變更。</p>						
<p>4.1 噪音計之計量單位為「分貝」，其符號為「dB」。</p>	<p>2.1 噪音計之計量單位為「分貝」，其符號為「dB」。</p>	<p>節次變更。</p>						

4.2 噪音計應在主機明顯之處標明以下資訊： (1) 噪音計等級的標示(例：1級或2級)。 (2) 製造廠商名稱或商標。 (3) 產品型號及出廠器號(包含麥克風之型號及器號)。	2.2 噪音計應於明顯之處標識下列事項： (1) 類型(1型或2型)。 (2) 製造廠商名稱或標記。 (3) 型號及器號。如麥克風部份若與本體可分離者，須在噪音計本體加上麥克風器號。	一、節次變更。 二、參考 IEC 61672-1 第5.1.5 節之規定，修訂噪音計等級的標示。 三、酌作文字修正。
4.3 噪音計必須有A頻率加權特性。	2.3 噪音計必須有A頻率加權特性。	節次變更。
4.4 噪音計必須有時間加權特性，如快速(F或FAST)，慢速(S或SLOW)；積分式噪音計必須有時間平均特性。	2.4 噪音計必須有一個時間加權特性，如快速(F或FAST)，慢速(S或SLOW)。	一、節次變更。 二、參考 IEC 61672-1 第5.1.9 節之規定，新增積分式噪音計需求規格。
4.5 噪音計應備有保持量測音壓位準最大值之功能。	2.5 噪音計必須有交流或直流信號輸出端子，否則應備有保持量測音壓位準最大值之功能。	一、節次變更。 二、酌作文字修正。
4.6 噪音計應具備有過載輸入之指示裝置。	2.6 噪音計之放大器達到飽和狀態時，應具備有表示過載輸入之指示裝置。	一、節次變更。 二、酌作文字修正。
4.7 噪音計指示器上之顯示值解析度(最小分度值)應在0.1dB以下。	2.7 噪音計指示器上之最小分度值如為數位顯示者應在0.1dB以下，如為類比顯示者應在1dB以下。	一、節次變更。 二、參考 IEC 61672-1 第5.18.2 節之規定，修訂噪音計顯示值之解析度。
4.8 噪音計指示器上的顯示範圍至少有60dB。 註：如可調整不同顯示範圍，則具有時間加權功能的噪音計兩相鄰的顯示範圍需有30dB的重疊；具有時間平均功能的噪音計兩相鄰的顯示範圍需有40dB的重疊。	2.8 噪音計不論是類比式或數位式，其指示器範圍至少有15dB。	一、節次變更。 二、參考 IEC 61672-1 第5.18.2 節之規定，修訂噪音計的顯示範圍。 三、參考 IEC 61672-1 第5.6.9 節之規定，明定噪音計兩相鄰指示範圍的重疊顯示部分。 四、酌作文字修正。
	2.9 噪音計類比指示器之主分度線，必須在明顯處所之表面記載其指示數值，其分度線間隔必須在1mm以上。	一、本節刪除。 二、噪音計類比指示器已不適用。
4.9 噪音計使用乾電池時，須有提供電壓不足之警示裝置。	2.10 噪音計使用乾電池時，須有提供電壓不足之警示裝置。	節次變更。
4.10 麥克風必須是可以與噪音計本體分離的，以容許插入電氣測試訊號於前置放大器的輸入端。		一、本節新增。 二、參考 IEC 61672-1 第5.1.16 節之規定，明定噪音計的麥克風是可分離的。
5. 檢定程序		本節新增。
5.1 噪音計之構造及規格特性，依下列項目進行檢定之。 (1) 構造。 (2) 校正查核頻率的指示。 (3) 自雜訊。 (4) 聲訊號頻率加權。 (5) 電訊號頻率加權。		一、本節新增。 二、明定噪音計檢定、檢查項目，以資明確。

<p>(6) 位準線性度。 (7) 位準範圍切換。 (8) 猶發音響應。 (9) 過載指示。 (10) 1k Hz 頻率及時間加權。 (11) 長時間穩定性。 (12) 高位準穩定性。</p> <p>註：若為多通道噪音計系統，依受檢測者需求的通道數，逐一檢定所有的檢定項目。</p>		
5.2 構造：應符合第 4 節之規定。		本節新增。
<p>5.3 校正查核頻率的指示：</p> <p>(1) 將噪音計設定在使用手冊規定之頻率、時間加權特性(如未規定可設定於頻率加權 A、時間加權 Fast)及參考位準範圍。</p> <p>(2) 如圖 1 噪音計接收已校正的聲音校正器發出之音壓位準進行指示值的調整及記錄。</p>		<p>一、本節新增。</p> <p>二、參考 IEC 61672-3 第 10 節之規定，明定校正查核頻率的指示值的調整及記錄程序。</p>
 <p>聲音校正器 噪音計</p> <p>圖 1 噪音計查核頻率校正</p>		
<p>5.4 自雜訊之檢測規定如下：</p> <p>(1) 噪音計自雜訊量測分為安裝麥克風及使用電性輸入訊號裝置取代麥克風兩種測試方式。</p> <p>(2) 安裝麥克風檢測時，噪音計設定在音量最大感受範圍並選擇 A 頻率加權，如圖 2 所示在無響音場裝置的環境進行量測。</p> <p>(3) 使用電性輸入訊號裝置取代麥克風檢測時，參考說明書上所規定的端接方式如圖 3，噪音計設定在音量最大感受範圍並選擇 A 頻率加權。</p> <p>(4) 記錄噪音計至少 30 s 時間平均之 A 加權所顯示的音量。</p> <p>(5) 如果不能測定時間平均音量，必須從間隔 60 s 的 10 次隨機觀察中測量 S 時間加權(或 F 時間加權)音量。</p> <p>註：自雜訊的 A 加權音量只作為參考之用，並不用來評鑑是否符合要求，無相關的不確定度。</p>		<p>一、本節新增。</p> <p>二、參考 IEC 61672-3 第 11 節之規定，明定自雜訊之檢測程序。</p>

<p>圖 2 噪音計聲訊號自雜訊測試</p>	<p>圖 3 噪音計電訊號自雜訊測試</p>	
<p>5.5 聲訊號頻率加權檢測規定如下：</p> <p>5.5.1 於無響音場裝置中檢測</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 噪音計設定在頻率加權A及參考位準範圍(或使用者量測的位準範圍)。 (2) 使用已校正過的標準麥克風為參考標準於無響音場裝置的環境測試頻率加權。 (3) 如圖 4 所示接妥各儀器，並依製造商所規定之暖機時間暖機。 (4) 調整正弦訊號產生器的輸出電壓使標準麥克風距離測試聲源1 m處各頻率之音壓位準超過70 dB以上。 (5) 在頻率為31.5 Hz、63 Hz、125 Hz、250 Hz、500 Hz、1 kHz、2 kHz、4 kHz、8 kHz 及 16 kHz 測定聲音訊號的頻率加權。 (6) 將受檢噪音計取代標準麥克風於相同位置處，量測頻率加權之音壓位準值，計算與標準麥克風無加權時各頻率音壓位準之差值。 (7) 於無響音場裝置中應執行在1.00 m、1.05 m 及 1.10 m 不同距離之檢測的算術平均值。 	<p>3.3 噪音計整機在第 3.2 節之測試條件下，於製造商所規定之暖機時間暖機後，採用替代法在無響室內進行準確度檢定或檢查如圖 1 所示。讀取受檢噪音計在距離音源1 m 之自由音場下，對於頻率為125 Hz、200 Hz、250 Hz、315 Hz、400 Hz、500 Hz、630 Hz、800 Hz、1 kHz、1.25 kHz、1.6 kHz、2 kHz、2.5 kHz、3.15 kHz 及 4 kHz，音壓位準為94 dB之正弦波之量測值，與標準麥克風在相同條件下之量測值，再計算兩者各頻率差值之平均值做為器差。1型噪音計之器差不得超過±0.7 dB，2型噪音計之器差不得超過±1.0 dB。</p>	<p>本節新增。</p> <p>一、節次變更並酌作文字修正。</p> <p>二、參考 IEC 61672-3 第 12.7 節之規定，聲訊號頻率加權檢測頻率為125 Hz、1 kHz、8 kHz，及 OIML R58 聲訊號頻率加權檢測頻率為10 Hz 至 20 kHz，修訂聲訊號頻率加權檢測頻率。</p> <p>三、參考 IEC 61672-2 第 9.4.3.4 節無響音場裝置檢測時使用音源之音壓位準超過背景音壓位準30 dB 以上，修訂音源的音壓位準。</p> <p>四、參考 IEC 61672-2 第 9.4.3.8 至少必須在無響音場裝置內另兩個聲源至麥克風的其他適當距離或位置上重複所規定的測試，明定檢測次數。</p> <p>五、有關噪音計之器差及公差，參考 IEC 61672-3 第 12.6 節及 IEC 61672-1 第 5.5 節之規定，明定於本技術規範第 7.1 節中。</p>
<p>圖 4 噪音計聲訊號頻率加權檢測系統 (無響音場裝置)</p>	<p>圖 1 噪音計的自雜訊測試系統</p>	
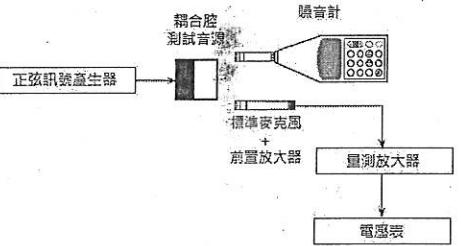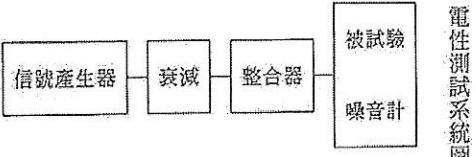
<p>5.5.2 於耦合腔裝置中檢測 (當無響音場裝置無法符合自由場環境之頻率且於 250 Hz 以下時，得使用耦合腔裝置進行聲訊號頻率加權檢測)</p> <ol style="list-style-type: none"> (1)噪音計設定在頻率加權 A 及參考位準範圍(或使用者量測的位準範圍)。 (2)使用已校正過的標準麥克風為參考標準安裝於耦合腔測試聲源中測試頻率加權。 (3)如圖 5 所示接妥各儀器，並依製造商所規定之暖機時間暖機。 (4)調整正弦訊號產生器的輸出電壓使標準麥克風在各頻率之音壓位準為 70 dB 至 125 dB。 (5)將受檢噪音計取代標準麥克風，量測頻率加權之音壓位準值，計算與標準麥克風無加權時各頻率音壓位準之差值。 (6)於耦合腔裝置中應執行至少 3 次檢測的算術平均值。每次測試時必須將麥克風自耦合腔中移除重新安裝。  <p>圖 5 噪音計聲訊號頻率加權檢測系統 (耦合腔裝置)</p>		<p>一、本節新增。 二、參考 IEC 61672-3 第 12.1 節之規定，新增聲訊號頻率加權檢測於耦合腔裝置之程序。 三、參考 IEC 61672-3 第 12.9 及 12.10 節之規定，明定耦合腔裝置的輸出音壓。 四、參考 IEC 61672-2 第 9.4.4.2 明定耦合腔裝置適用的頻率範圍。 五、參考 IEC 61672-2 第 9.4.4.5 明定耦合腔裝置量測的次數。</p>
<p>5.6 電訊號頻率加權檢測規定如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1)將噪音計上之麥克風取下，以與麥克風阻抗相等之電性輸入訊號裝置連接於噪音計的前置放大器端。 (2)如圖 6 所示接妥各儀器，並依製造商所規定之暖機時間暖機。 (3)噪音計之位準範圍設定在參考位準範圍(或使用者量測的位準範圍)，頻率加權設定在 Z、A 或 C 加權特性。 (4)正弦訊號產生器輸出為 1 kHz 正弦訊號，調整輸入訊號的位準，使噪音計顯示於主要指示範圍上限以下 5 dB 處，並以此為參考位準。 (5)按表 1 之頻率點逐一改變訊號頻率，求取相對於參考位準之差值並逐點作出響應曲線，以取得 Z、A、C 各加權特性，按表 1 之公差之規定，判定合格與否。 (6)量測值應為至少 3 次檢測的算術平 	<p>3.4 噪音計在如圖 2 所示之電性測試下進行頻率加權特性檢定。用 1 kHz 正弦信號通過與麥克風阻抗相等之等效電阻抗，輸入至噪音計，使其顯示於主要指示範圍上限以下 6 dB 處，並以此為參考位準。再按表 1 之頻率點逐一改變信號頻率，求取相對於參考位準並逐點作出響應曲線，以取得線性、A、C 各加權特性，按表 1 之公差之規定，判定合格與否。</p>  <p>圖 2 表 1 頻率加權特性在參考方向上相對自由音場之頻率響應及公差(單位：dB)</p>	<p>一、節次變更。 二、參考 IEC 61672-3 第 13.2 節之規定，修訂檢測的參考位準。 三、酌作文字修正。</p>

均值。



圖 6 噪音計電訊號頻率加權檢測系統

頻率 (Hz)	A 特性	C 特性	線性	公差	
				1型	2型
20	-50.5	-6.2	0	±3.0	±3.0
25	-44.7	-4.4	0	±2.0	±3.0
31.5	-39.4	-3.0	0	±1.5	±3.0
40	-34.6	-2.0	0	±1.5	±2.0
50	-30.2	-1.3	0	±1.5	±2.0
63	-26.2	-0.8	0	±1.5	±2.0
80	-22.5	-0.5	0	±1.5	±2.0
100	-19.1	0.3	0	±1.0	±1.5
125	-16.1	-0.2	0	±1.0	±1.5
160	-13.4	-0.1	0	±1.0	±1.5
200	-10.9	-0.0	0	±1.0	±1.5
250	-8.6	-0.0	0	±1.0	±1.5
315	-6.6	-0.0	0	±1.0	±1.5
400	-4.8	-0.0	0	±1.0	±1.5
500	-3.2	-0.0	0	±1.0	±1.5
630	-1.9	-0.0	0	±1.0	±1.5
800	-0.8	-0.0	0	±1.0	±1.5
1000	0.0	0.0	0	±1.0	±1.5
1250	+0.6	-0.0	0	±1.0	±1.5
1600	+1.0	-0.1	0	±1.0	±2.0
2000	+1.2	-0.2	0	±1.0	±2.0
2500	+1.3	-0.3	0	±1.0	±2.5
3150	+1.2	-0.5	0	±1.0	±2.5
4000	+1.0	-0.8	0	±1.0	±3.0
5000	+0.5	-1.3	0	±1.5	±3.5
6300	-0.1	-2.0	0	+1.5 -2.0	±4.5
8000	-1.1	-3.0	0	+1.5 -3.0	±5.0
10000	-2.5	-4.4	0	+2.0 -4.0	+5.0 -∞
12500	-4.3	-6.2	0	+3.0 -6.0	+5.0 -∞

3.5 噪音計有效值特性之檢定是在如圖 3 所示之電性測試下進行，將噪音計置於 A 加權位置；時間加權則放在「慢速」檔。用連續序列之衝擊音與 2 kHz 之連續信號相比較之方法進行。

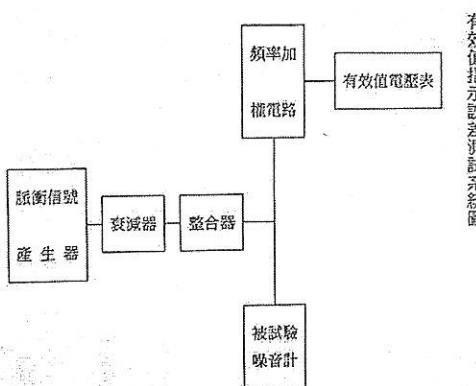


圖 3

3.5.1 用 2 kHz 正弦信號通過與麥克風阻抗相等之等效電阻抗，輸入至噪音計，調整輸入之信號振幅，使噪音計指示在主

一、本節刪除。

二、參考 IEC 61672-3 之規定，無此檢定項目。


一、本節刪除。


二、參考 IEC 61672-3 之規定，無此檢定項目。

	<p>要指示範圍上限以下 2 dB 處，並以此為參考位準。</p>																
	<p>3.5.2 施加重複頻率為 40 Hz，分別以持續時間為 5.5 ms、2.0 ms、0.5 ms 之衝擊音測試，噪音計指示值與參考位準之差值應符合表 2 之規定。</p> <p>表 2 峰值因數檢定檢查公差 (單位: dB)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>峰值因數 CF 類型</th> <th>$1 < CF \leq 3$</th> <th>$3 < CF \leq 5$</th> <th>$5 < CF \leq 10$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 型</td> <td>± 0.5</td> <td>± 1.0</td> <td>± 1.5</td> </tr> <tr> <td>2 型</td> <td>± 1.0</td> <td>± 1.0</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	峰值因數 CF 類型	$1 < CF \leq 3$	$3 < CF \leq 5$	$5 < CF \leq 10$	1 型	± 0.5	± 1.0	± 1.5	2 型	± 1.0	± 1.0	—	<p>一、本節刪除。 二、參考 IEC 61672-3 之規定，無此檢定項目。</p>			
峰值因數 CF 類型	$1 < CF \leq 3$	$3 < CF \leq 5$	$5 < CF \leq 10$														
1 型	± 0.5	± 1.0	± 1.5														
2 型	± 1.0	± 1.0	—														
5.7 位準線性度檢測規定如下：	<p>(1) 將噪音計上之麥克風取下，以與麥克風阻抗相等之電性輸入訊號裝置連接於噪音計的前置放大器端。</p> <p>(2) 圖 7 所示接妥各儀器，並依製造商所規定之暖機時間暖機。</p> <p>(3) 噪音計之位準範圍設定在參考位準範圍(或使用者量測的位準範圍)，頻率加權設定在 A 加權特性。時間加權設定在 F 時間加權或時間平均。</p> <p>(4) 正弦訊號產生器的輸出為 8 kHz 正弦訊號，調整輸入訊號的位準，使噪音計顯示於參考位準，在此參考位準之位準線性偏差為零。</p> <p>(5) 調整衰減器(或正弦訊號產生器)的位準，以 5 dB 以下的變化來調整輸入訊號的位準。當與線性工作範圍的下限或上限相距不到 5 dB 時以及當位準超過上限時，輸入訊號位準的變化則減到 1 dB。</p> <p>(6) 計算訊號產生器輸入位準與相對應噪音計輸出位準之線性偏差。</p> <p>(7) 量測值應為至少 3 次檢測的算術平均值。</p>	<p>3.8 噪音計在主要指示範圍內之系統位準線性及相隔 1 dB 和相隔 10 dB 各點之線性檢定方法是在電性測試下進行，其線性公差如表 5、表 6 之規定。測試線性之參考位準是參考音壓位準。可將噪音計置於參考音壓位準範圍，並分別施加 31.5 Hz、1 kHz 及 8 kHz 正弦信號，再調整衰減器使噪音計顯示值位於受檢位置，以精密衰減器之調整量來檢查指示器之刻度值。</p> <p>表 5 其系統位準線性公差 (單位: dB)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>類型 讀值</th> <th>1 型</th> <th>2 型</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>主要指示範圍內</td> <td>± 0.7</td> <td>± 1.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>表 6 相隔二個不同位準之線性公差 (單位: dB)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>類型 讀值</th> <th>1 型</th> <th>2 型</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>主要指示範圍內，相隔 1 dB 之 2 個測試點</td> <td>± 0.2</td> <td>± 0.3</td> </tr> <tr> <td>主要指示範圍內，相隔 10 dB 之 2 個測試點</td> <td>± 0.4</td> <td>± 0.6</td> </tr> </tbody> </table>	類型 讀值	1 型	2 型	主要指示範圍內	± 0.7	± 1.0	類型 讀值	1 型	2 型	主要指示範圍內，相隔 1 dB 之 2 個測試點	± 0.2	± 0.3	主要指示範圍內，相隔 10 dB 之 2 個測試點	± 0.4	± 0.6
類型 讀值	1 型	2 型															
主要指示範圍內	± 0.7	± 1.0															
類型 讀值	1 型	2 型															
主要指示範圍內，相隔 1 dB 之 2 個測試點	± 0.2	± 0.3															
主要指示範圍內，相隔 10 dB 之 2 個測試點	± 0.4	± 0.6															
		<p>一、節次變更。 二、參考 IEC 61672-3 第 16.1 節之規定，檢測頻率為 8 kHz，考量較寬的頻率範圍，檢測頻率未修訂。 三、參考 IEC 61672-3 第 16.3 節之規定，檢測的間距為 5 dB；在主要指示範圍上限以下 5 dB 處及下限以上 5 dB 處相隔 1 dB，修訂檢測的衰減器間距。 四、酌作文字修正。</p>															
5.8 位準範圍切換檢測規定如下(適用於多個位準範圍之噪音計)：	<p>(1) 將噪音計上之麥克風取下，以與麥克風阻抗相等之電性輸入訊號裝置連接於噪音計的前置放大器端。</p> <p>(2) 如圖 7 所示接妥各儀器，並依製造商所規定之暖機時間暖機。</p> <p>(3) 噪音計之位準範圍設定在參考位準範圍(或使用者量測的位準範圍)，頻率加權設定在 A 加權特性。</p>	<p>3.6.1 用 2 kHz 正弦信號通過與麥克風阻抗相等之等效電阻抗，輸入至噪音計，調整輸入之信號振幅，使噪音計指示在主要指示範圍上限以下 4 dB 處，並以此為參考位準。</p> <p>3.6.2 施加持續時間為 200 ms (對快速) 及 500 ms (對慢速) 之 2 kHz 單個衝擊音輸入受檢噪音計。</p>															

<p><u>時間加權設定在 F 時間加權或時間平均。</u></p> <p>(4) <u>正弦訊號產生器的輸出為 1 kHz 正弦訊號，調整輸入訊號的位準，使噪音計顯示於主要指示範圍上限以下 5 dB。</u></p> <p>(5) <u>改變噪音計位準範圍切換器各級範圍檔，再調整精密衰減器(或正弦訊號產生器)，使噪音計指示不變。</u></p> <p>(6) <u>計算位準範圍切換器改變量與精密衰減器(或正弦訊號產生器)改變量之差。</u></p> <p>(7) <u>量測值應為至少 3 次檢測的算術平均值。</u></p>	<p>3.9 噪音計之位準範圍切換器檢定，是在電性測試下進行。是分別以 31.5 Hz、1 kHz 及 8 kHz 之正弦信號經過精密衰減器輸入受檢噪音計，在主要指示範圍上限以下 2 dB，並改變噪音計位準範圍切換器各級範圍檔，再調整精密衰減器，使噪音計指示不變；位準範圍切換器改變量與精密衰減器之改變量之差，即為位準範圍切換器之偏差值，其值應滿足表 7 之規定。</p> <p>表 7 噪音計位準範圍切換器之公差 (單位: dB)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">類型 頻率(Hz)</th> <th>1 型</th> <th>2 型</th> </tr> <tr> <th>31.5~8000</th> <th>± 0.5</th> <th>± 0.7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	類型 頻率(Hz)	1 型	2 型	31.5~8000	± 0.5	± 0.7				<p>一、節次變更。 二、參考 IEC 61672-3 第 18.1 節之規定，檢測頻率為 4 kHz，頻率加權設定為 A 加權，修改檢測頻率及頻率加權設定。 三、參考 IEC 61672-3 第 18.4 節之規定，修改檢測參考位準。 四、參考 IEC 61672-3 第 18.5、18.6、18.7 節之規定，修改檢測的持續時間。 五、酌作文字修正。</p>								
類型 頻率(Hz)	1 型		2 型																
	31.5~8000	± 0.5	± 0.7																
<p>5.9 猝發音響應檢測規定如下：</p> <p>(1) <u>將噪音計上之麥克風取下，以與麥克風阻抗相等之電性輸入訊號裝置連接於噪音計的前置放大器端。</u></p> <p>(2) <u>圖 8 所示接妥各儀器，並依製造商所規定之暖機時間暖機。</u></p> <p>(3) <u>噪音計之位準範圍設定在參考位準範圍(或使用者量測的位準範圍)，頻率加權設定在 A 加權特性。時間加權設定在 F 時間加權、S 時間加權或時間平均。</u></p> <p>(4) <u>正弦訊號產生器的輸出為 4 kHz 正弦訊號，調整輸入訊號的位準，使噪音計顯示於主要指示範圍上限以下 3 dB 處，並以此為參考位準。</u></p> <p>(5) <u>保持與上述位準相同的輸入訊號，用持續時間為 200 ms、2 ms 及 0.25 ms(對快速及時間平均) 及 200 ms、2 ms(對慢速)之 4 kHz 單個暫態音輸入受檢噪音計，其最大顯示值與等幅連續正弦訊號顯示值之差值。</u></p> <p>(6) <u>量測值應為至少 3 次檢測的算術平均值。</u></p>	<p>3.6 噪音計之時間加權特性檢定是在電性測試下進行，用持續時間為 200 ms(對快速)及 500 ms(對慢速)之 2 kHz 單個衝擊音輸入受檢噪音計，其最大顯示值與等幅連續正弦訊號顯示值之差值應符合表 3 之規定。</p> <p>表 3 衝擊音之響應</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">檢波指 示器特 性</th> <th rowspan="2">測試衝 擊音之 持續時 間 (ms)</th> <th rowspan="2">相對於連 續信號響 應之測試 衝擊音之 最大響應 (dB)</th> <th colspan="2">公差 (dB)</th> </tr> <tr> <th>1 型</th> <th>2 型</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>快速</td> <td>200</td> <td>-1.0</td> <td>± 1.0</td> <td>$+1.0$ -2.0</td> </tr> <tr> <td>慢速</td> <td>500</td> <td>-4.1</td> <td>± 1.0</td> <td>± 2.0</td> </tr> </tbody> </table>	檢波指 示器特 性	測試衝 擊音之 持續時 間 (ms)	相對於連 續信號響 應之測試 衝擊音之 最大響應 (dB)	公差 (dB)		1 型	2 型	快速	200	-1.0	± 1.0	$+1.0$ -2.0	慢速	500	-4.1	± 1.0	± 2.0	<p>一、本節刪除。 二、參考 IEC 61672-3 之規定，無此檢定項目。</p>
檢波指 示器特 性	測試衝 擊音之 持續時 間 (ms)				相對於連 續信號響 應之測試 衝擊音之 最大響應 (dB)	公差 (dB)													
		1 型	2 型																
快速	200	-1.0	± 1.0	$+1.0$ -2.0															
慢速	500	-4.1	± 1.0	± 2.0															
<p>圖 8 噪音計猝發音響應檢測系統</p>	<p>3.7 噪音計之時間加權特性對突然加入之信號，而造成指示器之過越量(Over-shoot)之響應，其檢定方法在電性測試下進行。</p> <p>3.7.1 用 1 kHz 正弦信號通過與麥克風阻抗相等之等效電阻抗，輸入至噪音計，調</p>	<p>一、本節刪除。 二、參考 IEC 61672-3 之規</p>																	

	<p>整輸入之信號振幅，使噪音計指示在主要指示範圍上限以下 4 dB 處，並以此為參考位準。</p>	定，無此檢定項目。												
	<p>3.7.2 突然施加上述信號給噪音計，接著保持穩定，過越顯示值之偏差應符合表 4 之規定。</p> <p>表 4 最大過越量 (單位: dB)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>指示器特性</th> <th>類型</th> <th>1 型</th> <th>2 型</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>快速</td> <td></td> <td><1.1</td> <td><1.1</td> </tr> <tr> <td>慢速</td> <td></td> <td><1.6</td> <td><1.6</td> </tr> </tbody> </table>	指示器特性	類型	1 型	2 型	快速		<1.1	<1.1	慢速		<1.6	<1.6	<p>一、本節刪除。 二、參考 IEC 61672-3 之規定，無此檢定項目。</p>
指示器特性	類型	1 型	2 型											
快速		<1.1	<1.1											
慢速		<1.6	<1.6											
5.10 過載指示檢測規定如下：(適用於可以顯示時間平均音量的噪音計)	<p>(1) 將噪音計上之麥克風取下，以與麥克風阻抗相等之電性輸入訊號裝置連接於噪音計的前置放大器端。</p> <p>(2) 圖 9 所示接妥各儀器，並依製造商所規定之暖機時間暖機。</p> <p>(3) 位準範圍設定在最小感受音量範圍且設定 A 加權、時間平均音量。</p> <p>(4) 正弦訊號產生器的輸出為 4 kHz 正弦訊號，調整輸入訊號的位準，使噪音計顯示於主要指示範圍上限以下 1 dB 處。</p> <p>(5) 再從 4 kHz 穩定連續的正弦訊號提取正半個週期輸入噪音計，以 0.1 dB 的步進方式輸入訊號至噪音計出現過載指示，記錄此時的位準值，再輸入負半個週期的正弦訊號，以同樣的方式獲得位準值，計算兩者的差值。</p> <p>(6) 量測值應為至少 3 次檢測的算術平均值。</p>	<p>3.10 噪音計之過載指示之檢定，是在電性測試下進行。用 1 kHz 正弦信號通過與麥克風阻抗相等之等效電阻抗，輸入至噪音計。噪音計之頻率加權為 A，使信號顯示值低於其可測最大範圍之音壓位準 5 dB。然後將信號頻率逐點降到 20 Hz，同時按表 1 加權特性相應提高信號幅度，當超過規定信號加權幅度時，過載指示應有反應。</p>												
圖 9 噪音計過載指示檢測系統														
5.11 1 kHz 頻率及時間加權檢測規定如下：	<p>(1) 將噪音計上之麥克風取下，以與麥克風阻抗相等之電性輸入訊號裝置連接於噪音計的前置放大器端。</p> <p>(2) 圖 10 所示接妥各儀器，並依製造商所規定之暖機時間暖機。</p> <p>(3) 位準範圍設定在參考位準範圍且設定 A 加權、FAST。</p> <p>(4) 正弦訊號產生器的輸出為 1 kHz 正弦訊號。</p> <p>(5) 記錄切換至 C 加權及 Z 加權與 A 加</p>	<p>一、本節新增。 二、參考 IEC 61672-3 第 14 節之規定，變更過載指示的檢測程序。</p>												

<p>權時的差值。</p> <p>(6) 記錄切換至 SLOW 及時間平均與 FAST 的差值。</p> <p>(7) 量測值應為至少 3 次檢測的算術平均值。</p>  <p>圖 10 噪音計 1 kHz 頻率及時間加權檢測系統</p>		
<p>5.12 長時間穩定性檢測規定如下：</p> <p>(1) 將噪音計上之麥克風取下，以與麥克風阻抗相等之電性輸入訊號裝置連接於噪音計的前置放大器端。</p> <p>(2) 圖 11 所示接妥各儀器，並依製造商所規定之暖機時間暖機。</p> <p>(3) 噪音計之位準範圍設定在參考位準範圍(或使用者量測的位準範圍)，頻率加權設定在 A 加權特性。時間加權設定在 F 時間加權或時間平均 10 s。</p> <p>(4) 正弦訊號產生器的輸出為 1 kHz 正弦訊號，調整輸入訊號的位準，使噪音計在主要指示範圍顯示 60 dB，持續 30 分鐘。</p> <p>(5) 記錄噪音計顯示值於起始訊號與結束訊號之間的差異。</p> <p>(6) 量測值應為至少 3 次檢測的算術平均值。</p>  <p>圖 11 噪音計長時間穩定性檢測系統</p>		<p>一、本節新增。</p> <p>二、參考 IEC 61672-3 第 15 節之規定，明定長時間穩定性檢測程序。</p>
<p>5.13 高位準穩定性檢測規定如下：</p> <p>(1) 將噪音計上之麥克風取下，以與麥克風阻抗相等之電性輸入訊號裝置連接於噪音計的前置放大器端。</p> <p>(2) 如圖 12 所示接妥各儀器，並依製造商所規定之暖機時間暖機。</p> <p>(3) 噪音計之位準範圍設定在參考位準範圍(或使用者量測的位準範圍)，頻率加權設定在 A 加權特性。時間加權設定在 F 時間加權或時間平均 10 s。</p> <p>(4) 正弦訊號產生器的輸出為 1 kHz 正弦訊號，調整輸入訊號的位準，使噪音計顯示於主要指示範</p>		<p>一、本節新增。</p> <p>二、參考 IEC 61672-3 第 21 節之規定，明定高位準穩定性檢測程序。</p>

<p>圍上限以下 1 dB 處，持續 5 分鐘。</p> <p>(5) 記錄噪音計顯示值於起始訊號與結束訊號之間的差異。</p> <p>(6) 量測值應為至少 3 次檢測的算術平均值。</p>  <p>圖 12 噪音計高位準穩定性檢測系統</p>																																																																																																																																																																																																						
<p>5.14 噪音計之檢定合格有效期間，自附加檢定合格印證之日起至附加檢定合格印證月份之次月始日起算 2 年止。</p>	<p>3.13 噪音計之檢定合格有效期間為 2 年，自附加檢定合格印證之日起至附加檢定合格印證月份之次月始日起算 2 年止。</p>	<p>一、節次變更。 二、酌作文字修正。</p>																																																																																																																																																																																																				
<p>6. 檢查程序得採本技術規範中全部或部分檢定項目實施。</p>		<p>一、本節新增。 二、依據度量衡器檢定檢查辦法第十七條第二項之規定，增列檢查程序得採本技術規範中全部或部分檢定項目實施之規定。</p>																																																																																																																																																																																																				
<p>7. 檢定及檢查公差</p>		<p>一、本節新增。 二、檢定及檢查公差於各節中說明，為增加易讀性，新增本節次。</p>																																																																																																																																																																																																				
<p>7.1 噪音計之各項檢定公差如下：</p> <p>(1) 頻率加權：</p> <p>表 2 頻率加權特性及公差</p> <table border="1" data-bbox="119 1155 595 1906"> <thead> <tr> <th rowspan="2">標稱 頻率 (Hz)</th> <th colspan="3">頻率加權(dB)</th> <th colspan="2">公差(dB)</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>C</th> <th>Z</th> <th>1 級</th> <th>2 級</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>20</td><td>-50.5</td><td>-6.2</td><td>0.0</td><td>±2.0</td><td>±3.0</td></tr> <tr><td>25</td><td>-44.7</td><td>-4.4</td><td>0.0</td><td>+2.0;-1.5</td><td>±3.0</td></tr> <tr><td>31.5</td><td>-39.4</td><td>-3.0</td><td>0.0</td><td>±1.5</td><td>±3.0</td></tr> <tr><td>40</td><td>-34.6</td><td>-2.0</td><td>0.0</td><td>±1.0</td><td>±2.0</td></tr> <tr><td>50</td><td>-30.2</td><td>-1.3</td><td>0.0</td><td>±1.0</td><td>±2.0</td></tr> <tr><td>63</td><td>-26.2</td><td>-0.8</td><td>0.0</td><td>±1.0</td><td>±2.0</td></tr> <tr><td>80</td><td>-22.5</td><td>-0.5</td><td>0.0</td><td>±1.0</td><td>±2.0</td></tr> <tr><td>100</td><td>-19.1</td><td>-0.3</td><td>0.0</td><td>±1.0</td><td>±1.5</td></tr> <tr><td>125</td><td>-16.1</td><td>-0.2</td><td>0.0</td><td>±1.0</td><td>±1.5</td></tr> <tr><td>160</td><td>-13.4</td><td>-0.1</td><td>0.0</td><td>±1.0</td><td>±1.5</td></tr> <tr><td>200</td><td>-10.9</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>±1.0</td><td>±1.5</td></tr> <tr><td>250</td><td>-8.6</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>±1.0</td><td>±1.5</td></tr> <tr><td>315</td><td>-6.6</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>±1.0</td><td>±1.5</td></tr> <tr><td>400</td><td>-4.8</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>±1.0</td><td>±1.5</td></tr> <tr><td>500</td><td>-3.2</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>±1.0</td><td>±1.5</td></tr> <tr><td>630</td><td>-1.9</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>±1.0</td><td>±1.5</td></tr> <tr><td>800</td><td>-0.8</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>±1.0</td><td>±1.5</td></tr> <tr><td>1000</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>±0.7</td><td>±1.0</td></tr> <tr><td>1250</td><td>+0.6</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>±1.0</td><td>±1.5</td></tr> <tr><td>1600</td><td>+1.0</td><td>-0.1</td><td>0.0</td><td>±1.0</td><td>±2.0</td></tr> <tr><td>2000</td><td>+1.2</td><td>-0.2</td><td>0.0</td><td>±1.0</td><td>±2.0</td></tr> <tr><td>2500</td><td>+1.3</td><td>-0.3</td><td>0.0</td><td>±1.0</td><td>±2.5</td></tr> <tr><td>3150</td><td>+1.2</td><td>-0.5</td><td>0.0</td><td>±1.0</td><td>±2.5</td></tr> <tr><td>4000</td><td>+1.0</td><td>-0.8</td><td>0.0</td><td>±1.0</td><td>±3.0</td></tr> <tr><td>5000</td><td>+0.5</td><td>-1.3</td><td>0.0</td><td>±1.5</td><td>±3.5</td></tr> <tr><td>6300</td><td>-0.1</td><td>-2.0</td><td>0.0</td><td>+1.5;-2.0</td><td>±4.5</td></tr> <tr><td>8000</td><td>-1.1</td><td>-3.0</td><td>0.0</td><td>+1.5;-2.5</td><td>±5.0</td></tr> <tr><td>10000</td><td>-2.5</td><td>-4.4</td><td>0.0</td><td>+2.0;-3.0</td><td>+5.0; -∞</td></tr> <tr><td>12500</td><td>-4.3</td><td>-6.2</td><td>0.0</td><td>+2.0;-5.0</td><td>+5.0; -∞</td></tr> <tr><td>16000</td><td>-6.6</td><td>-8.5</td><td>0.0</td><td>+2.5;-16.0</td><td>+5.0; -∞</td></tr> <tr><td>20000</td><td>-9.3</td><td>-11.2</td><td>0.0</td><td>+3.0; -∞</td><td>+5.0; -∞</td></tr> </tbody> </table>	標稱 頻率 (Hz)	頻率加權(dB)			公差(dB)		A	C	Z	1 級	2 級	20	-50.5	-6.2	0.0	±2.0	±3.0	25	-44.7	-4.4	0.0	+2.0;-1.5	±3.0	31.5	-39.4	-3.0	0.0	±1.5	±3.0	40	-34.6	-2.0	0.0	±1.0	±2.0	50	-30.2	-1.3	0.0	±1.0	±2.0	63	-26.2	-0.8	0.0	±1.0	±2.0	80	-22.5	-0.5	0.0	±1.0	±2.0	100	-19.1	-0.3	0.0	±1.0	±1.5	125	-16.1	-0.2	0.0	±1.0	±1.5	160	-13.4	-0.1	0.0	±1.0	±1.5	200	-10.9	0.0	0.0	±1.0	±1.5	250	-8.6	0.0	0.0	±1.0	±1.5	315	-6.6	0.0	0.0	±1.0	±1.5	400	-4.8	0.0	0.0	±1.0	±1.5	500	-3.2	0.0	0.0	±1.0	±1.5	630	-1.9	0.0	0.0	±1.0	±1.5	800	-0.8	0.0	0.0	±1.0	±1.5	1000	0	0	0	±0.7	±1.0	1250	+0.6	0.0	0.0	±1.0	±1.5	1600	+1.0	-0.1	0.0	±1.0	±2.0	2000	+1.2	-0.2	0.0	±1.0	±2.0	2500	+1.3	-0.3	0.0	±1.0	±2.5	3150	+1.2	-0.5	0.0	±1.0	±2.5	4000	+1.0	-0.8	0.0	±1.0	±3.0	5000	+0.5	-1.3	0.0	±1.5	±3.5	6300	-0.1	-2.0	0.0	+1.5;-2.0	±4.5	8000	-1.1	-3.0	0.0	+1.5;-2.5	±5.0	10000	-2.5	-4.4	0.0	+2.0;-3.0	+5.0; -∞	12500	-4.3	-6.2	0.0	+2.0;-5.0	+5.0; -∞	16000	-6.6	-8.5	0.0	+2.5;-16.0	+5.0; -∞	20000	-9.3	-11.2	0.0	+3.0; -∞	+5.0; -∞	<p>一、本節新增。 二、參考 IEC 61672-3 第 12.6 節及 IEC 61672-1 第 5.5 節之規定，明定噪音計頻率加權之公差。</p> <p>三、參考 IEC 61672-3 第 16.5 節及 IEC 61672-1 第 5.6 節之規定，明定噪音計位準線性度之公差。</p> <p>四、參考 IEC 61672-3 第 18.8 節及 IEC 61672-1 第 5.9 節之規定，明定噪音計猝發音響應之公差。</p> <p>五、參考 IEC 61672-3 第 15.3 節及 IEC 61672-1 第 5.14 節之規定，明定噪音計長時間穩定性之公差。</p> <p>六、參考 IEC 61672-3 第 21.3 節及 IEC 61672-1 第 5.15 節之規定，明定噪音計高位準穩定性之公差。</p>
標稱 頻率 (Hz)		頻率加權(dB)			公差(dB)																																																																																																																																																																																																	
	A	C	Z	1 級	2 級																																																																																																																																																																																																	
20	-50.5	-6.2	0.0	±2.0	±3.0																																																																																																																																																																																																	
25	-44.7	-4.4	0.0	+2.0;-1.5	±3.0																																																																																																																																																																																																	
31.5	-39.4	-3.0	0.0	±1.5	±3.0																																																																																																																																																																																																	
40	-34.6	-2.0	0.0	±1.0	±2.0																																																																																																																																																																																																	
50	-30.2	-1.3	0.0	±1.0	±2.0																																																																																																																																																																																																	
63	-26.2	-0.8	0.0	±1.0	±2.0																																																																																																																																																																																																	
80	-22.5	-0.5	0.0	±1.0	±2.0																																																																																																																																																																																																	
100	-19.1	-0.3	0.0	±1.0	±1.5																																																																																																																																																																																																	
125	-16.1	-0.2	0.0	±1.0	±1.5																																																																																																																																																																																																	
160	-13.4	-0.1	0.0	±1.0	±1.5																																																																																																																																																																																																	
200	-10.9	0.0	0.0	±1.0	±1.5																																																																																																																																																																																																	
250	-8.6	0.0	0.0	±1.0	±1.5																																																																																																																																																																																																	
315	-6.6	0.0	0.0	±1.0	±1.5																																																																																																																																																																																																	
400	-4.8	0.0	0.0	±1.0	±1.5																																																																																																																																																																																																	
500	-3.2	0.0	0.0	±1.0	±1.5																																																																																																																																																																																																	
630	-1.9	0.0	0.0	±1.0	±1.5																																																																																																																																																																																																	
800	-0.8	0.0	0.0	±1.0	±1.5																																																																																																																																																																																																	
1000	0	0	0	±0.7	±1.0																																																																																																																																																																																																	
1250	+0.6	0.0	0.0	±1.0	±1.5																																																																																																																																																																																																	
1600	+1.0	-0.1	0.0	±1.0	±2.0																																																																																																																																																																																																	
2000	+1.2	-0.2	0.0	±1.0	±2.0																																																																																																																																																																																																	
2500	+1.3	-0.3	0.0	±1.0	±2.5																																																																																																																																																																																																	
3150	+1.2	-0.5	0.0	±1.0	±2.5																																																																																																																																																																																																	
4000	+1.0	-0.8	0.0	±1.0	±3.0																																																																																																																																																																																																	
5000	+0.5	-1.3	0.0	±1.5	±3.5																																																																																																																																																																																																	
6300	-0.1	-2.0	0.0	+1.5;-2.0	±4.5																																																																																																																																																																																																	
8000	-1.1	-3.0	0.0	+1.5;-2.5	±5.0																																																																																																																																																																																																	
10000	-2.5	-4.4	0.0	+2.0;-3.0	+5.0; -∞																																																																																																																																																																																																	
12500	-4.3	-6.2	0.0	+2.0;-5.0	+5.0; -∞																																																																																																																																																																																																	
16000	-6.6	-8.5	0.0	+2.5;-16.0	+5.0; -∞																																																																																																																																																																																																	
20000	-9.3	-11.2	0.0	+3.0; -∞	+5.0; -∞																																																																																																																																																																																																	

<p>2 級噪音計，位準線性偏差±1.1 dB 以下。</p> <p>(3) 猝發音響應：</p> <p>表 3 猝發音響應及公差</p> <table border="1" data-bbox="119 246 610 527"> <thead> <tr> <th rowspan="2">猝發音 持續時間(ms)</th><th colspan="2">猝發音響應(dB)</th><th colspan="2">公差(dB)</th></tr> <tr> <th>F 時間 加權</th><th>時間平均</th><th>1 級</th><th>2 級</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>200</td><td>-1.0</td><td>-7.0</td><td>±0.5</td><td>±1.0</td></tr> <tr> <td>2</td><td>-18.0</td><td>-27.0</td><td>+1.0;-1.5</td><td>+1.0;-2.5</td></tr> <tr> <td>0.25</td><td>-27.0</td><td>-36.0</td><td>+1.0;-3.0</td><td>+1.5;-5.0</td></tr> <tr> <td></td><td>S 時間 加權</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>200</td><td>-7.4</td><td></td><td>±0.5</td><td>±1.0</td></tr> <tr> <td>2</td><td>-27.0</td><td></td><td>+1.0;-3.0</td><td>+1.0;-5.0</td></tr> </tbody> </table> <p>(4) 過載指示檢測： 偏差±1.5 dB 以下。</p> <p>(5) 1 kHz 頻率及時間加權檢測： 頻率加權切換偏差±0.2 dB 以下。 時間加權切換偏差±0.1 dB 以下。</p> <p>(6) 長時間穩定性： 1 級噪音計，±0.1 dB 以下。 2 級噪音計，±0.3 dB 以下。</p> <p>(7) 高位準穩定性： 1 級噪音計，±0.1 dB 以下。 2 級噪音計，±0.3 dB 以下。</p>	猝發音 持續時間(ms)	猝發音響應(dB)		公差(dB)		F 時間 加權	時間平均	1 級	2 級	200	-1.0	-7.0	±0.5	±1.0	2	-18.0	-27.0	+1.0;-1.5	+1.0;-2.5	0.25	-27.0	-36.0	+1.0;-3.0	+1.5;-5.0		S 時間 加權				200	-7.4		±0.5	±1.0	2	-27.0		+1.0;-3.0	+1.0;-5.0		
猝發音 持續時間(ms)		猝發音響應(dB)		公差(dB)																																					
	F 時間 加權	時間平均	1 級	2 級																																					
200	-1.0	-7.0	±0.5	±1.0																																					
2	-18.0	-27.0	+1.0;-1.5	+1.0;-2.5																																					
0.25	-27.0	-36.0	+1.0;-3.0	+1.5;-5.0																																					
	S 時間 加權																																								
200	-7.4		±0.5	±1.0																																					
2	-27.0		+1.0;-3.0	+1.0;-5.0																																					
<p>7.2 噪音計之各項檢定在涵蓋機率為 95 %，最大容許擴充不確定度如表 4。</p> <p>表 4 檢定項目之最大容許擴充不確定度</p> <table border="1" data-bbox="119 1031 579 1345"> <thead> <tr> <th>檢定項目</th><th>最大容許擴充不確定度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A、C、Z 頻率 加權</td><td>0.60 dB(10 Hz 至 4 kHz) 0.70 dB(4 kHz 以上至 10 kHz) 1.00 dB(10 kHz 以上至 20 kHz)</td></tr> <tr> <td>位準線性偏差</td><td>0.30 dB</td></tr> <tr> <td>猝發音響應</td><td>0.30 dB</td></tr> <tr> <td>過載顯示</td><td>0.25 dB</td></tr> <tr> <td>1 kHz 頻率及 時間加權</td><td>0.20 dB</td></tr> <tr> <td>長時間穩定性</td><td>0.10 dB</td></tr> <tr> <td>高度穩定性</td><td>0.10 dB</td></tr> </tbody> </table>	檢定項目	最大容許擴充不確定度	A、C、Z 頻率 加權	0.60 dB(10 Hz 至 4 kHz) 0.70 dB(4 kHz 以上至 10 kHz) 1.00 dB(10 kHz 以上至 20 kHz)	位準線性偏差	0.30 dB	猝發音響應	0.30 dB	過載顯示	0.25 dB	1 kHz 頻率及 時間加權	0.20 dB	長時間穩定性	0.10 dB	高度穩定性	0.10 dB		<p>一、本節新增。 二、參考 IEC 61672-1 附錄 B 之規定，明定噪音計各檢定項目之最大容許擴充不確定度。</p>																							
檢定項目	最大容許擴充不確定度																																								
A、C、Z 頻率 加權	0.60 dB(10 Hz 至 4 kHz) 0.70 dB(4 kHz 以上至 10 kHz) 1.00 dB(10 kHz 以上至 20 kHz)																																								
位準線性偏差	0.30 dB																																								
猝發音響應	0.30 dB																																								
過載顯示	0.25 dB																																								
1 kHz 頻率及 時間加權	0.20 dB																																								
長時間穩定性	0.10 dB																																								
高度穩定性	0.10 dB																																								
	<p>3.11 噪音計之檢定檢查報告中應載明受檢噪音計之器號。若麥克風和噪音計為分離式者，則須同時載明麥克風和噪音計之器號。</p>	<p>一、本節刪除。 二、於檢定合格印證及證書中說明。</p>																																							
<p>7.3 噪音計之檢查公差與檢定公差相同。</p>	<p>3.12 噪音計之檢查公差與檢定公差相同。</p>	<p>一、節次變更。 二、酌作文字修正。</p>																																							
<p>8. 檢定合格印證及證書</p>	<p>4. 檢定合格印證</p>	<p>節次變更及酌作文字修正。</p>																																							
<p>8.1 噪音計之檢定合格印證位置，在主機上蓋明顯處黏貼檢定合格單。</p>	<p>4.1 噪音計之檢定合格印證位置在主機外蓋明顯處黏貼檢定合格單。</p>	<p>一、節次變更。 二、酌作文字修正。</p>																																							
<p>8.2 檢定合格後應發給檢定合格證書。</p>	<p>4.2 噪音計經檢定合格後，應發給檢定合格證書。</p>	<p>一、節次變更。 二、酌作文字修正。</p>																																							
<p>8.3 噪音計檢定合格證書應記載下列項目：申請者、地址、規格、廠牌、型號、器號、類型、檢定合格單號碼、檢定日期、有效期限及其他必要事項。</p>		<p>一、本節新增。 二、參考現行噪音計檢定合格證書內容，明定檢定合格證書應記載之項目。</p>																																							